

მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფის გაყიდვის შესახებ განცხადება

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი ყიდის გამოყენებულ მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფსა და თანმხლებ აღჭურვილობას. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადის გამოგზავნა.

გასაყიდი ფასი: 85 000 USD.

გასაყიდი ობიექტი

მწარმოებელი და მოდელი	General Electric, Signa Echospeed
ტიპი / ველის სიმძლავრე	MRI / 1.5 T
გამოშვება / ინსტალაცია	2005 / 2006
სერიული ნომერი	R4258
ბორის დიამეტრი / მაგიდის დატვირთვა	70 სმ / 200 კგ
პელიუმის მაჩვენებელი	67.4%

კომპლექტაცია და ტექნიკური მდგომარეობა

მოყვება სპილენძის RF კაბინა (7 × 4.8 × 3.8 მ), HP xw8200 სამუშაო სადგური, EXCITE 3 RF კაბინეტი, GE Digital Energy SG Series 100 kVA UPS, Sumitomo F-50H პელიუმის კომპრესორი, კომპრესორისა და გრადიენტის ჩილერები და 11 ქოილი. ქოილების სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში.

ცნობილი დაზიანებები: გრადიენტის მართვის ბლოკი და პელიუმის კომპრესორის ჩილერი დაზიანებულია. კარდიო, ტორსის, მცირე ფლექს, მკერდისა და მუცელ-გულმკერდის ქოილები დასატესტია. აპარატის სრული ფუნქციონირება დადასტურებული არ არის.

დათვალიერება და განაცხადის წარდგენა

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ადგილზე შეამოწმონ აღჭურვილობა და კომპლექტაცია. შესყიდვის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, 2026 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით მოგვწეროთ საკონტაქტო პირს, მიუთითოთ თქვენი სახელი ან კომპანიის დასახელება და საკონტაქტო ტელეფონი. საბოლოო პირობები შეთანხმდება ხელშეკრულებით.

დათვალიერების ადგილი: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. 83ა
განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2026 წლის 12 ოქტომბერი
საკონტაქტო პირი: მამუკა გაბელია · m.gabelia@vian.health · 595 95 30 55

დანართი 1 — კომპლექტაციისა და მდგომარეობის სია

პელიუმუს დონე — 67.4; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

RF კაბინა(შემადგენლობა/ზომები) — სპილენძი, სიგრძე 7მ, სიგანე 4.8მ, სიმაღლე 3.8მ; მდგომარეობა: კარგი.

ვორქსთეიშენი — hp workstation xw8200; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

კაბინეტი RF, ძალოვანი — EXCITE 3 RF; მდგომარეობა: დაზიანებულია გრადიენტის მართვის ბლოკი.

უწყვეტი კვების წყარო UPS — GE Digital Energy SG series 100KVA; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

პელიუმის კომპრესორი — Sumitomo F-50H; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

კომპრესორის ჩილერი — მოდელი მითითებული არ არის; მდგომარეობა: დაზიანებული.

გრადიენტის ჩილერი — LYTION; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

თავის ქოილი — SPLIT HEAD COIL, P/N 2341973; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

თავის ქოილი — მოდელი მითითებული არ არის; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

თავის ქოილი — 8NVHEAD_A, 8NVARRAY_A; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

კარდიო ქოილი — 8 CHANNEL CARDIAC ARRAY COIL; მდგომარეობა: დასატესტი.

მხრის ქოილი — PHASED ARRAY SHOULDER COIL; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

მუხლის ქოილი — QUADKNEE; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

სპინალური ქოილი — 8CH CTL; მდგომარეობა: დამაკმაყოფილებელი.

ტორსის ქოილი — TORSO ARRAY; მდგომარეობა: დასატესტი.

ფლექს ქოილი, პატარა — GENERAL PURPOSE FLEX; მდგომარეობა: დასატესტი.

მკერდის ქოილი — BREASTS ARRAY COIL; მდგომარეობა: დასატესტი.


მუცელ-გულმკერდის ქოილი — 8CH BODY ARRAY; მდგომარეობა: დასატესტი.

დანართი 2 — ფოტომასალა

01. დასახელება — მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფი




02. პელიუმის დონე — 67.4

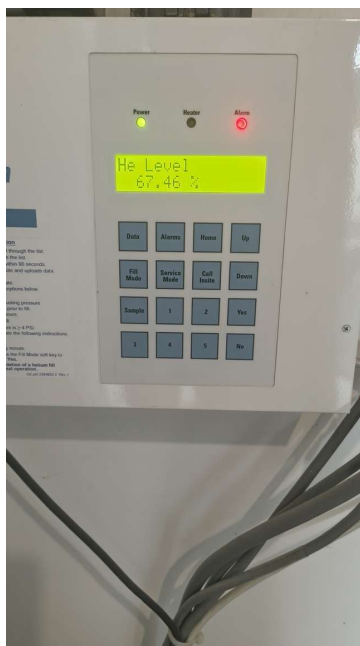

03. ვორქსთეიშენი — hp workstation xw8200



04. კაბინეტი RF, ძაღოვანი — EXCITE 3 RF

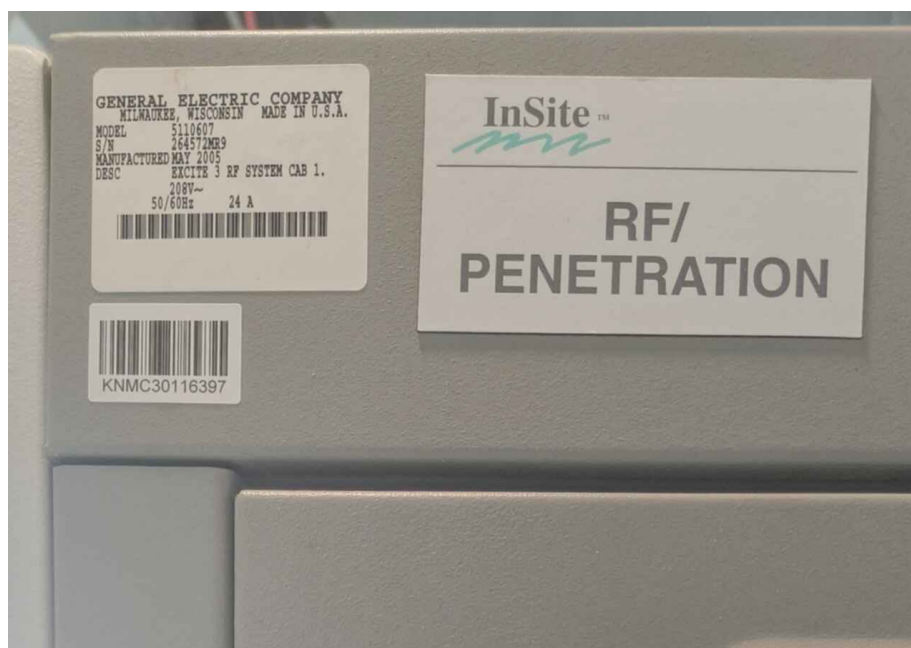

05. კაბინეტი RF, ძაღოვანი — EXCITE 3 RF




06. უწყვეტი კვების წყარო UPS — GE Digital Energy SG series 100KVA



07. უწყვეტი კვების წყარო UPS — GE Digital Energy SG series 100KVA



08. ჰელიუმის კომპრესორი — Sumitomo F-50H

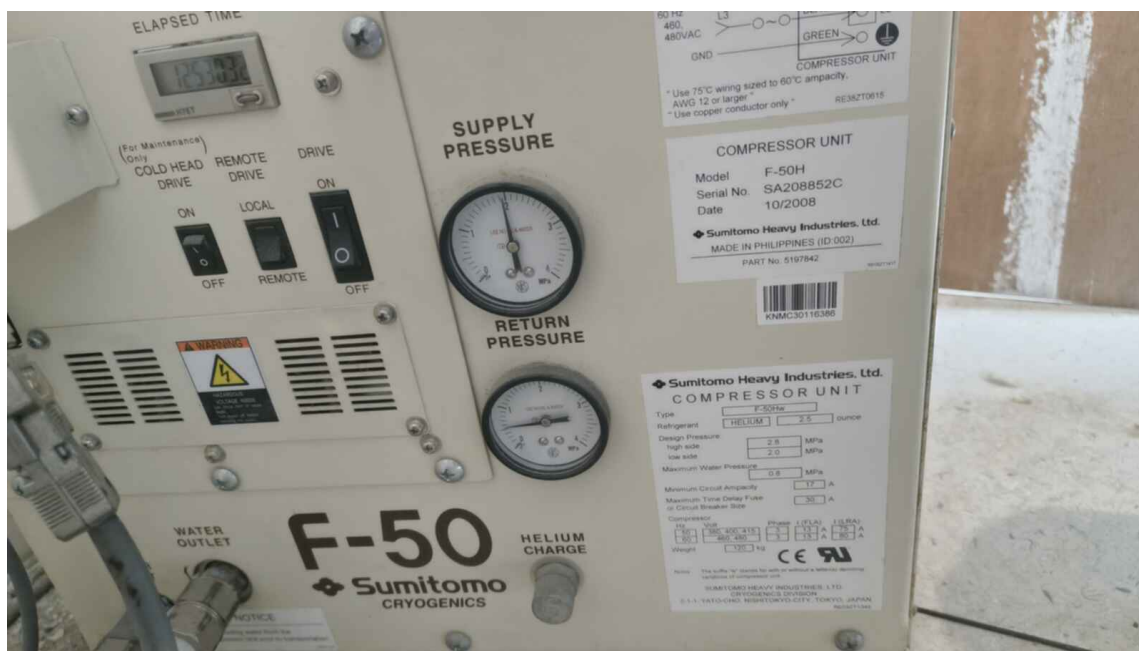

09. კომპრესორის ჩილერი



10. თავის ქოილი — SPLIT HEAD COIL, P/N 2341973



11. თავის ქოილი



12. თავის ქოილი — 8NVHEAD_A, 8NVARRAY_A



13. კარდიო ქოილი — 8 CHANNEL CARDIAC ARRAY COIL



14. მხრის ქოილი — PHASED ARRAY SHOULDER COIL



15. მუხლის ქოილი — QUADKNEE



16. სპინალური ქოილი — 8CH CTL



17. ტორსის ქოილი — TORSO ARRAY



18. ფლექს ქოილი, პატარა — GENERAL PURPOSE FLEX



19. მკერდის ქოილი — BREASTS ARRAY COIL



20. მკერდის ქოილი — BREASTS ARRAY COIL



21. მუცელ-გულმკერდის ქოილი — 8CH BODY ARRAY

